


Tryon

A simplicidade de um clássico

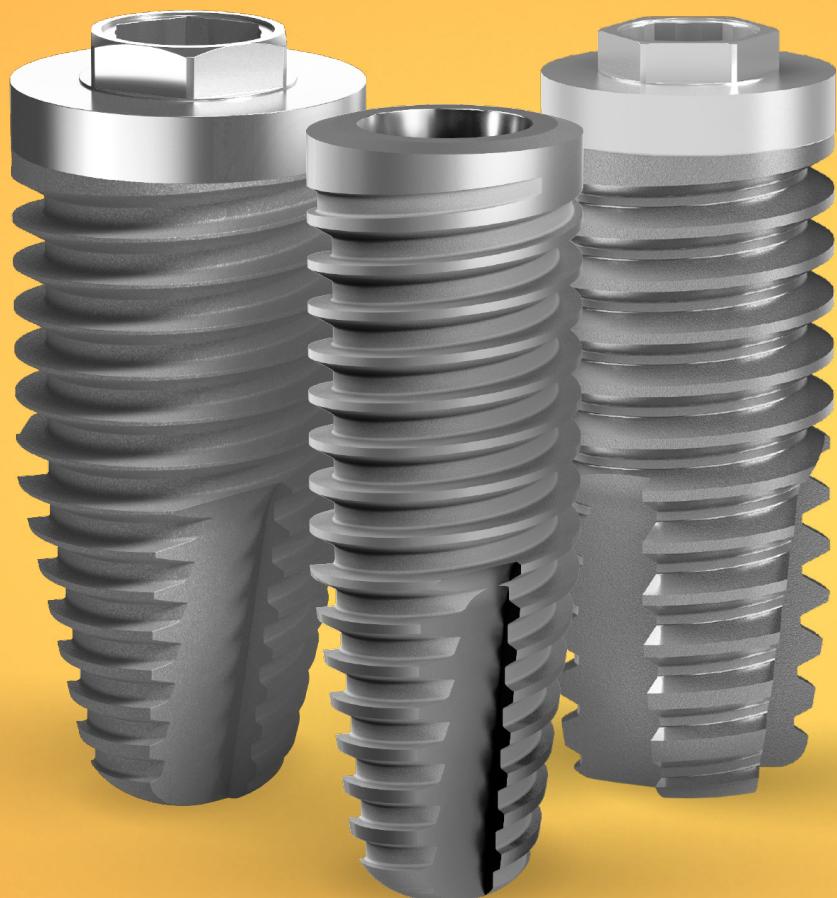


KIT CIRÚRGICO TRYON

SIMPLOCIADE E MÁXIMA FUNCIONALIDADE
PARA AS SUAS CIRURGIAS

Tryon

A simplicidade de um clássico

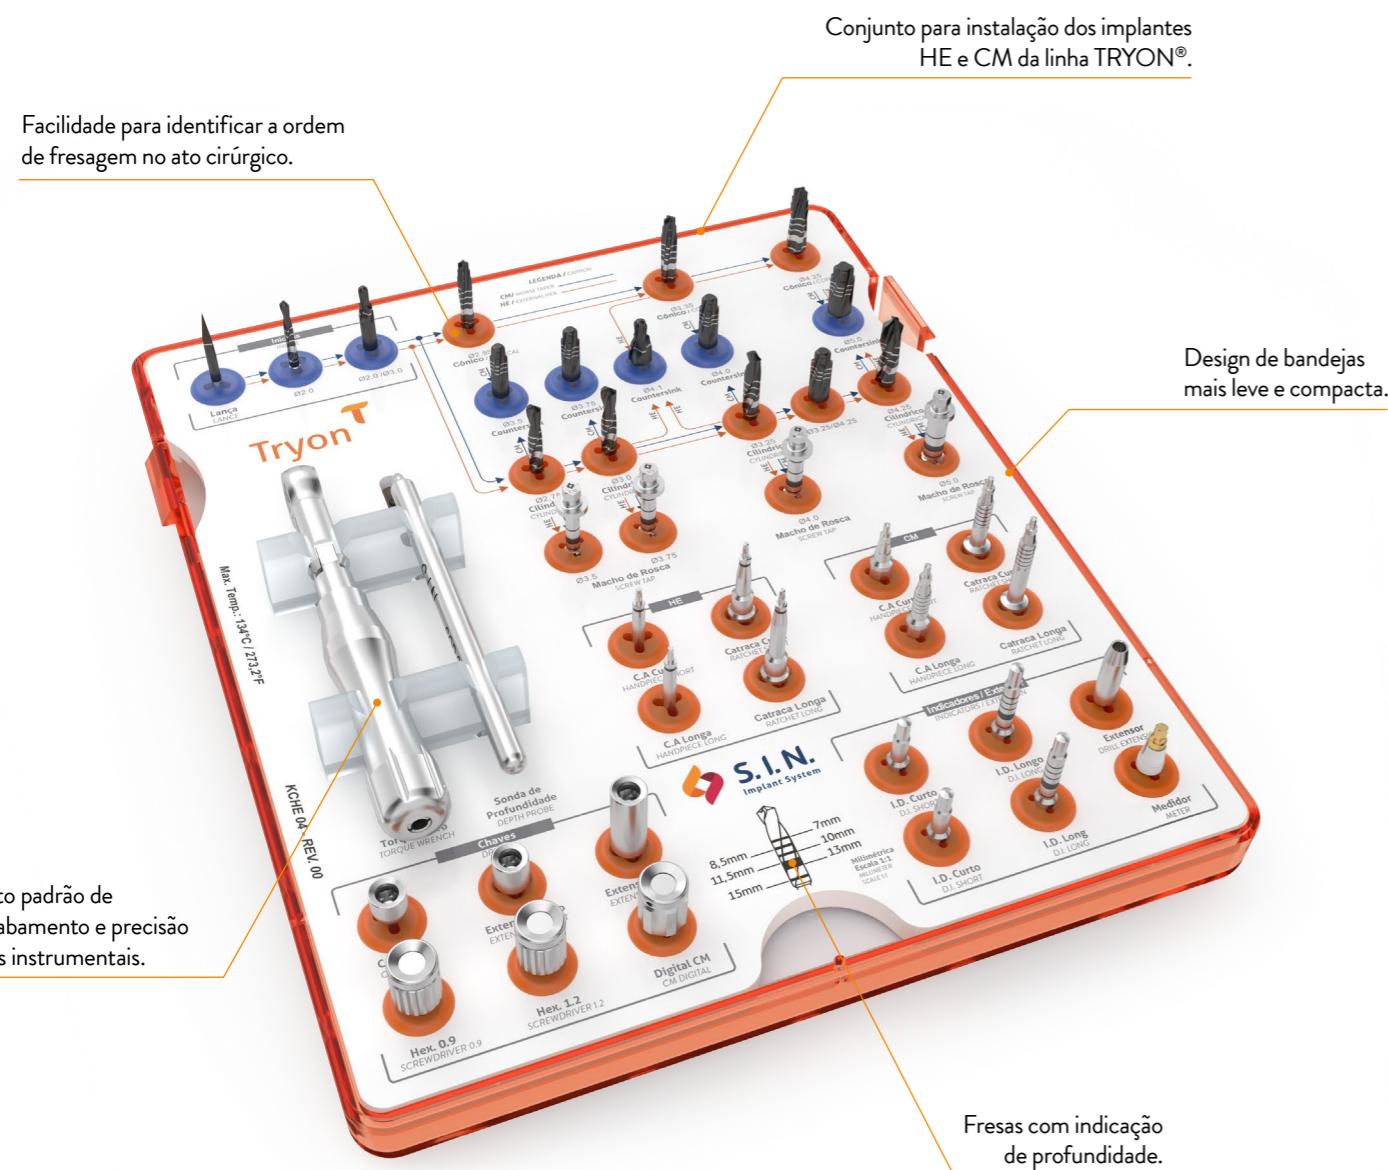

CÓDIGO DO PRODUTO: KCHE 04
CÓDIGO CAIXA ORGANIZADORA: COHE 04


OTRYON® é o implante clássico da S.I.N. O sistema de implante TRYON® Hexágono Externo foi desenvolvido com referência no conceito do maior nome da Implantodontia mundial: Professor Per-Ingvar Bränemark.

Acompanhando a evolução da implantodontia, o TRYON® possui a conexão Hexágono Externo e também Cone Morse, ambos com duplo ataque ácido e macrogeometria que garante alta estabilidade primária, eficácia e segurança para suas cirurgias.

Com mais de 10 anos no mercado, o TRYON® é um implante com vasta documentação científica e já contribuiu com mais de 3.000.000 sorrisos em todo mundo.



- Conexão Hexagonal Externa e Cone Morse.
- Fabricado em Titânio Comercialmente Puro (Tipo Grau 4): Metal levíssimo, muito resistente à corrosão, desgaste e a fratura.



- Compatível com a linha 3.6 FIT: possibilita o uso de Plataforma Switching para a linha HE, beneficiando áreas estéticas e anteriores, reduzindo o risco de perda óssea e microgaps.



- Superfície tratada com duplo ataque ácido: rugosidade ideal que proporciona uma osseointegração segura.



- Indicado principalmente para protocolos ou próteses múltiplas.



- Grande variedade de componentes protéticos.



- Possui rosca externa com diâmetro de corpo variado e plataforma com diâmetros de 3,5; 3,75; 4,0; 4,1 e 5,0 mm: proporcionando rápida inserção e menor trauma.
- Instalação feita com torque interno e sem montador.



- Excelente Custo x Benefício.




- Alta estabilidade no tecido ósseo.



- 2 opções de chave para instalação (contra ângulo e catraca).



Medidas técnicas TRYON® SAT CONE MORSE CILÍNDRICO

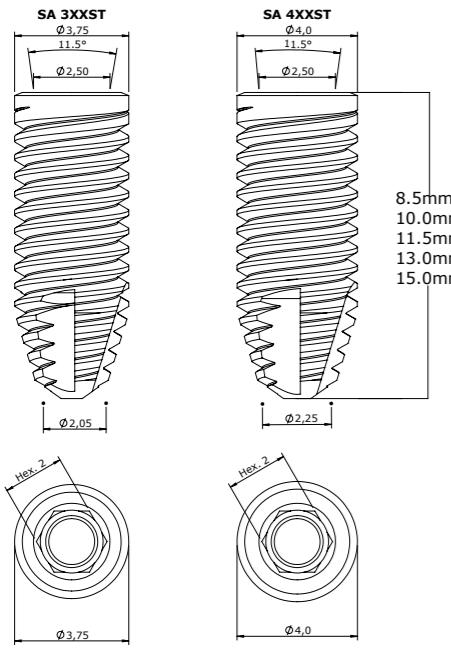


- Indicado para ossos tipos III e IV.
- Recomenda-se a instalação 1,5 mm infraósssea.
- Torque máximo em cirurgia: 80N.cm.
- Fresas (Lança e Helicoidal): velocidade 1500 rpm.
- Fresas (Piloto e Countersink): velocidade 800 rpm.
- Compatível com componentes Cone Morse 11,5°.

INDICAÇÕES DE USO CLÍNICO:

- 3,75 mm - Incisivos centrais, incisivos laterais e caninos.
- 4,0 mm - Caninos, pré-molares e molares

Medidas técnicas TRYON® SC CONE MORSE CÔNICO

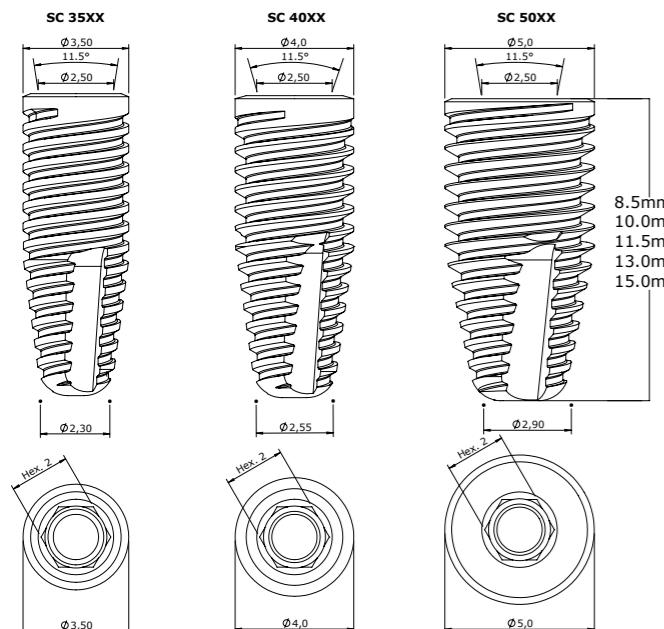


- Indicado para ossos tipos III e IV.
- Recomenda-se a instalação 1,5 mm infraósssea.
- Torque máximo em cirurgia: 80N.cm.
- Fresas (Lança e Helicoidal): velocidade 1.500 rpm.
- Fresas (Piloto e Countersink): velocidade 800 rpm.
- Compatível com componentes Cone Morse 11,5°.

INDICAÇÕES DE USO CLÍNICO:

- 3,5 mm - Incisivos centrais, incisivos laterais e caninos.
- 4,0 mm - Caninos, pré-molares e molares
- 5,0 mm - Molares

Medidas técnicas TRYON® ST CONE MORSE CILÍNDRICO

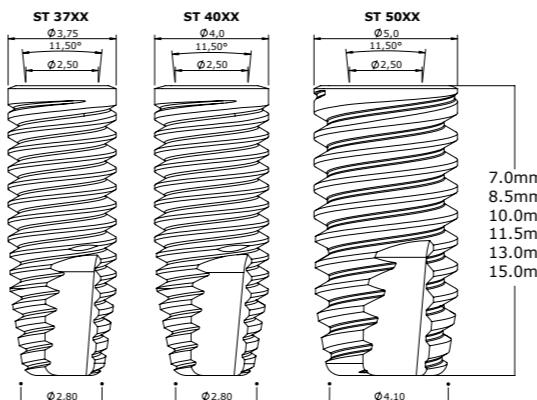


- Indicado para ossos tipos I e II.
- Recomenda-se a instalação 1,5 mm infraósssea.
- Torque máximo em cirurgia: 80N.cm.
- Fresas (Lança e Helicoidal): velocidade 1500 rpm.
- Fresas (Piloto e Countersink): velocidade 800 rpm.
- Compatível com componentes Cone Morse 11,5°.

*Exceto a fresa helicoidal FHTD 4215, velocidade recomendada é de 800 rpm.

INDICAÇÕES DE USO CLÍNICO:

- 3,75 mm - Incisivos centrais e laterais superiores, caninos e pré-molares
- 4,0 mm - Caninos, pré-molares e molares
- 5,0 mm - Molares

Medidas técnicas TRYON® CY HEXÁGONO EXTERNO CILÍNDRICO

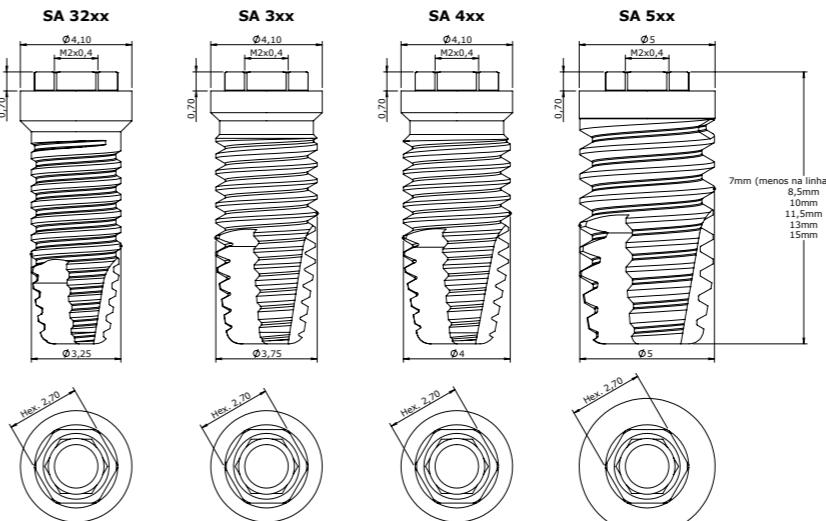


- Indicado para ossos tipos I e II.
- Instalação a nível ósseo.
- Rotação de inserção: 20 rpm.
- Torque máximo em cirurgia: 80 N.cm.
- Fresas (Lança e Helicoidal): velocidade 1.500 rpm.
- Fresas (Piloto e Countersink): velocidade 800 rpm.

*Exceto a fresa helicoidal FHTD 4215, velocidade recomendada é de 800 rpm.

INDICAÇÕES DE USO CLÍNICO:

- 3,25 mm - Incisivos laterais e incisivos centrais inferior
- 3,75 mm - Incisivos centrais e laterais superiores, caninos e pré-molares
- 4,0 mm - Incisivos centrais superiores, caninos, pré-molares e molares
- 5,0 mm - Molares

Medidas técnicas TRYON® CO HEXÁGONO EXTERNO CÔNICO

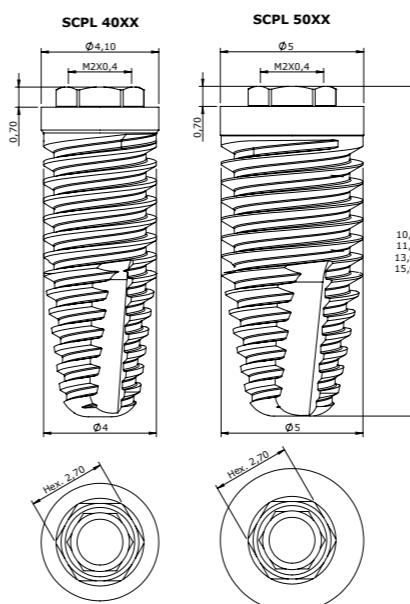

- Indicado para ossos tipos III e IV.
- Instalação a nível ósseo.
- Rotação das fresas iniciais: 1500 rpm.
- Rotação das fresas cônicas: 800 rpm.
- Torque máximo em cirurgia: 80 N.cm.

INDICAÇÕES DE USO CLÍNICO:

- 4,0 mm - Incisivos centrais superiores, caninos, pré-molares e molares
- 5,0 mm - Molares



Conheça o **Implantat**, o streaming educacional da S.I.N.



0800 770 8290(BR)
www.sinimplantsystem.com.br

Visite nossas Redes Sociais:



[/sinimplantsystem](https://www.facebook.com/sinimplantsystem)



[@sinbrasiloficial](https://www.instagram.com/sinbrasiloficial)



[/sinimplantsystem](https://www.linkedin.com/company/sinimplantsystem/)



[S.I.N. Implant System](https://www.youtube.com/S.I.N._Implant_System)



[/sin_implant](https://www.tiktok.com/@sin_implant)